Desmistificando inclusões em Revestimentos MegaVest e como obter Resultados.

com **Marcelo Bercovyte**

ODONTOMEGA

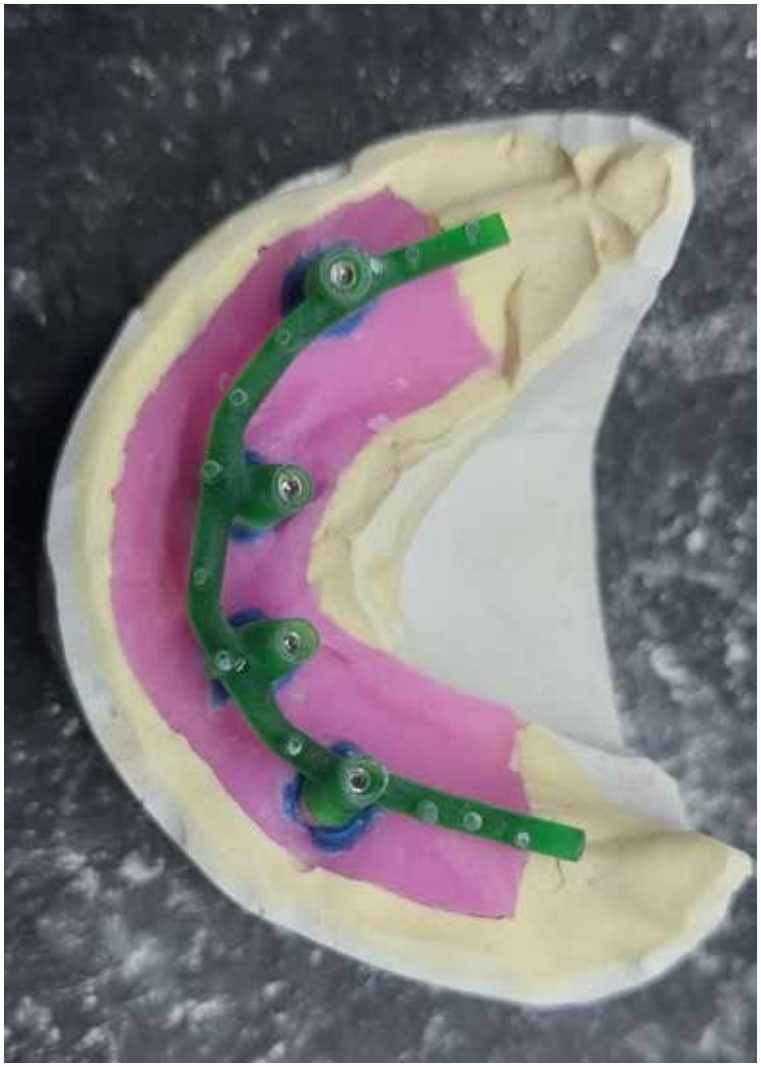

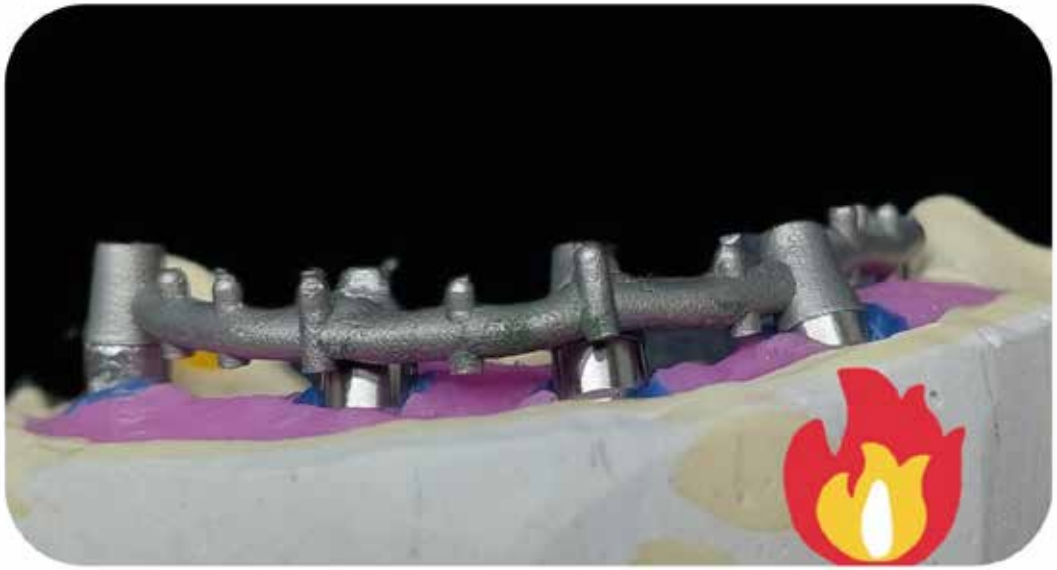

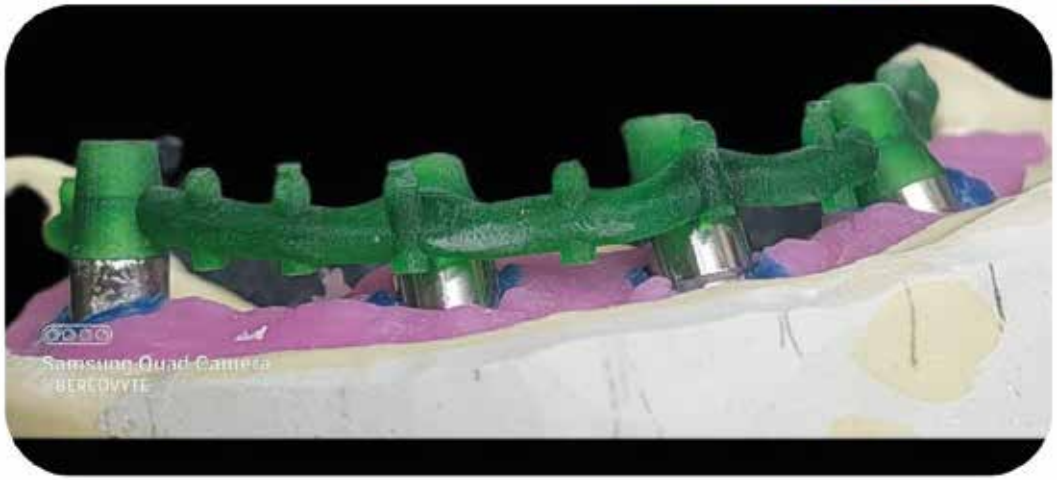
Samsung Quad Camera
BERCOVYTE

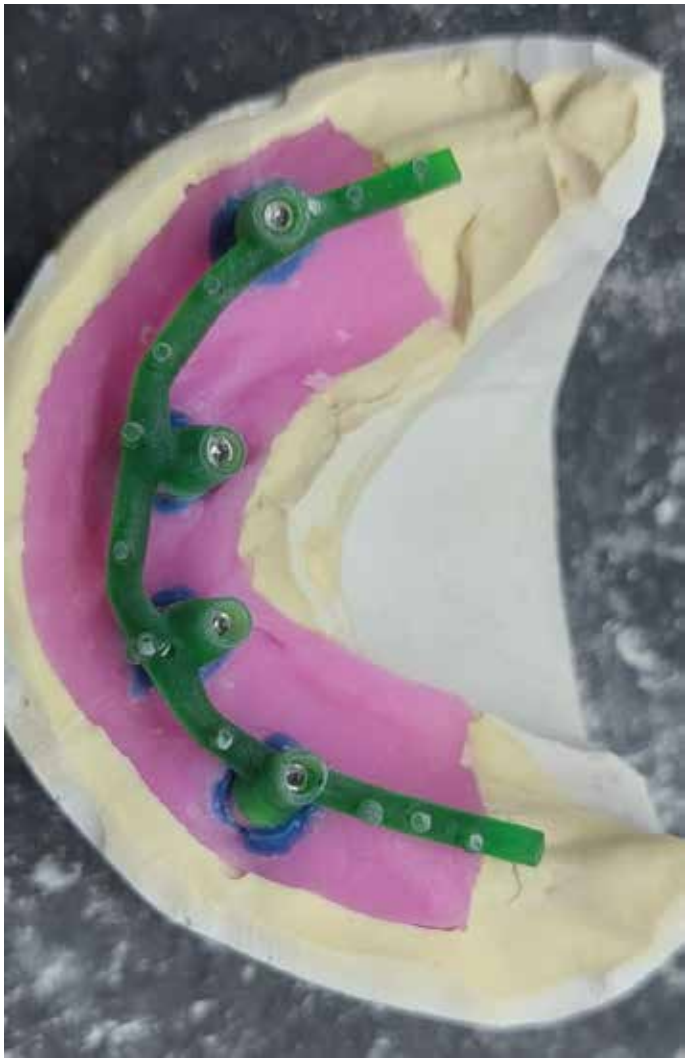

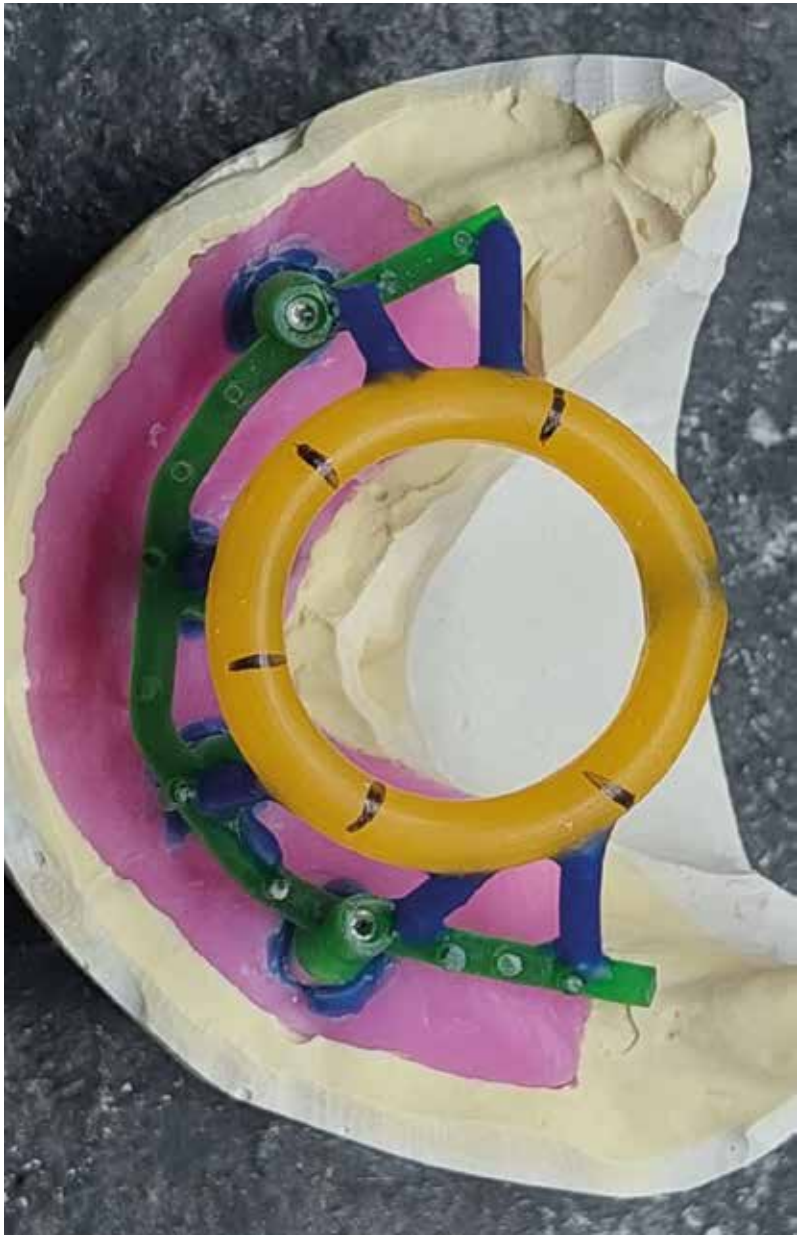

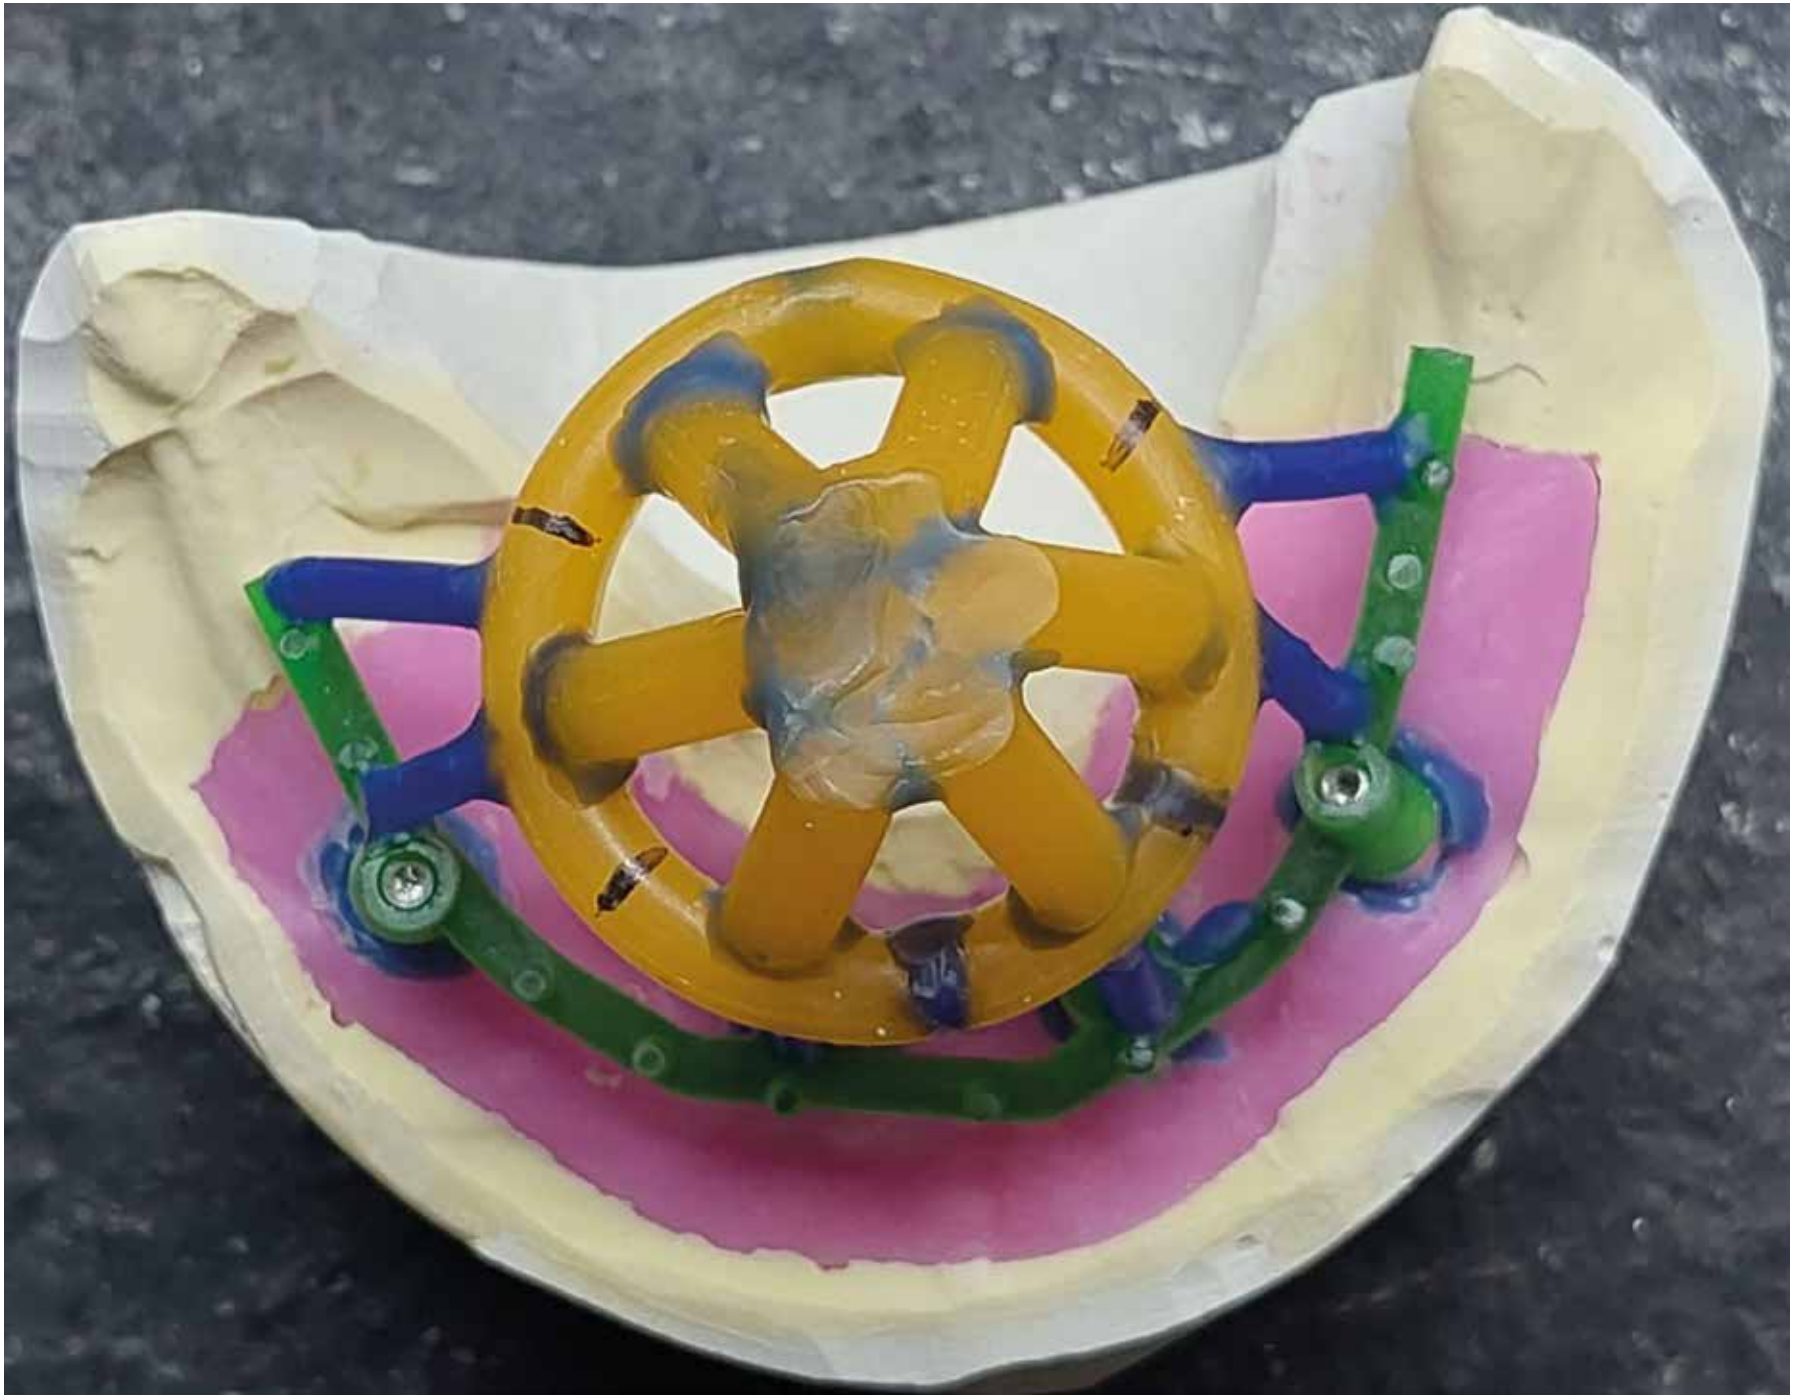

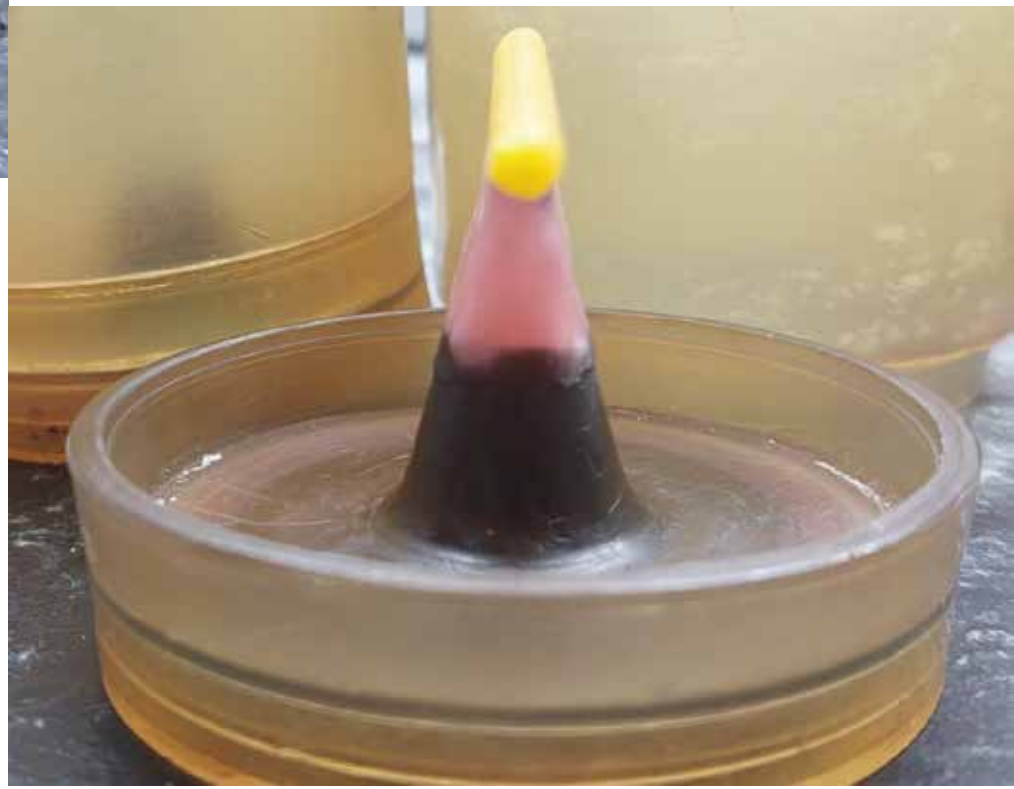

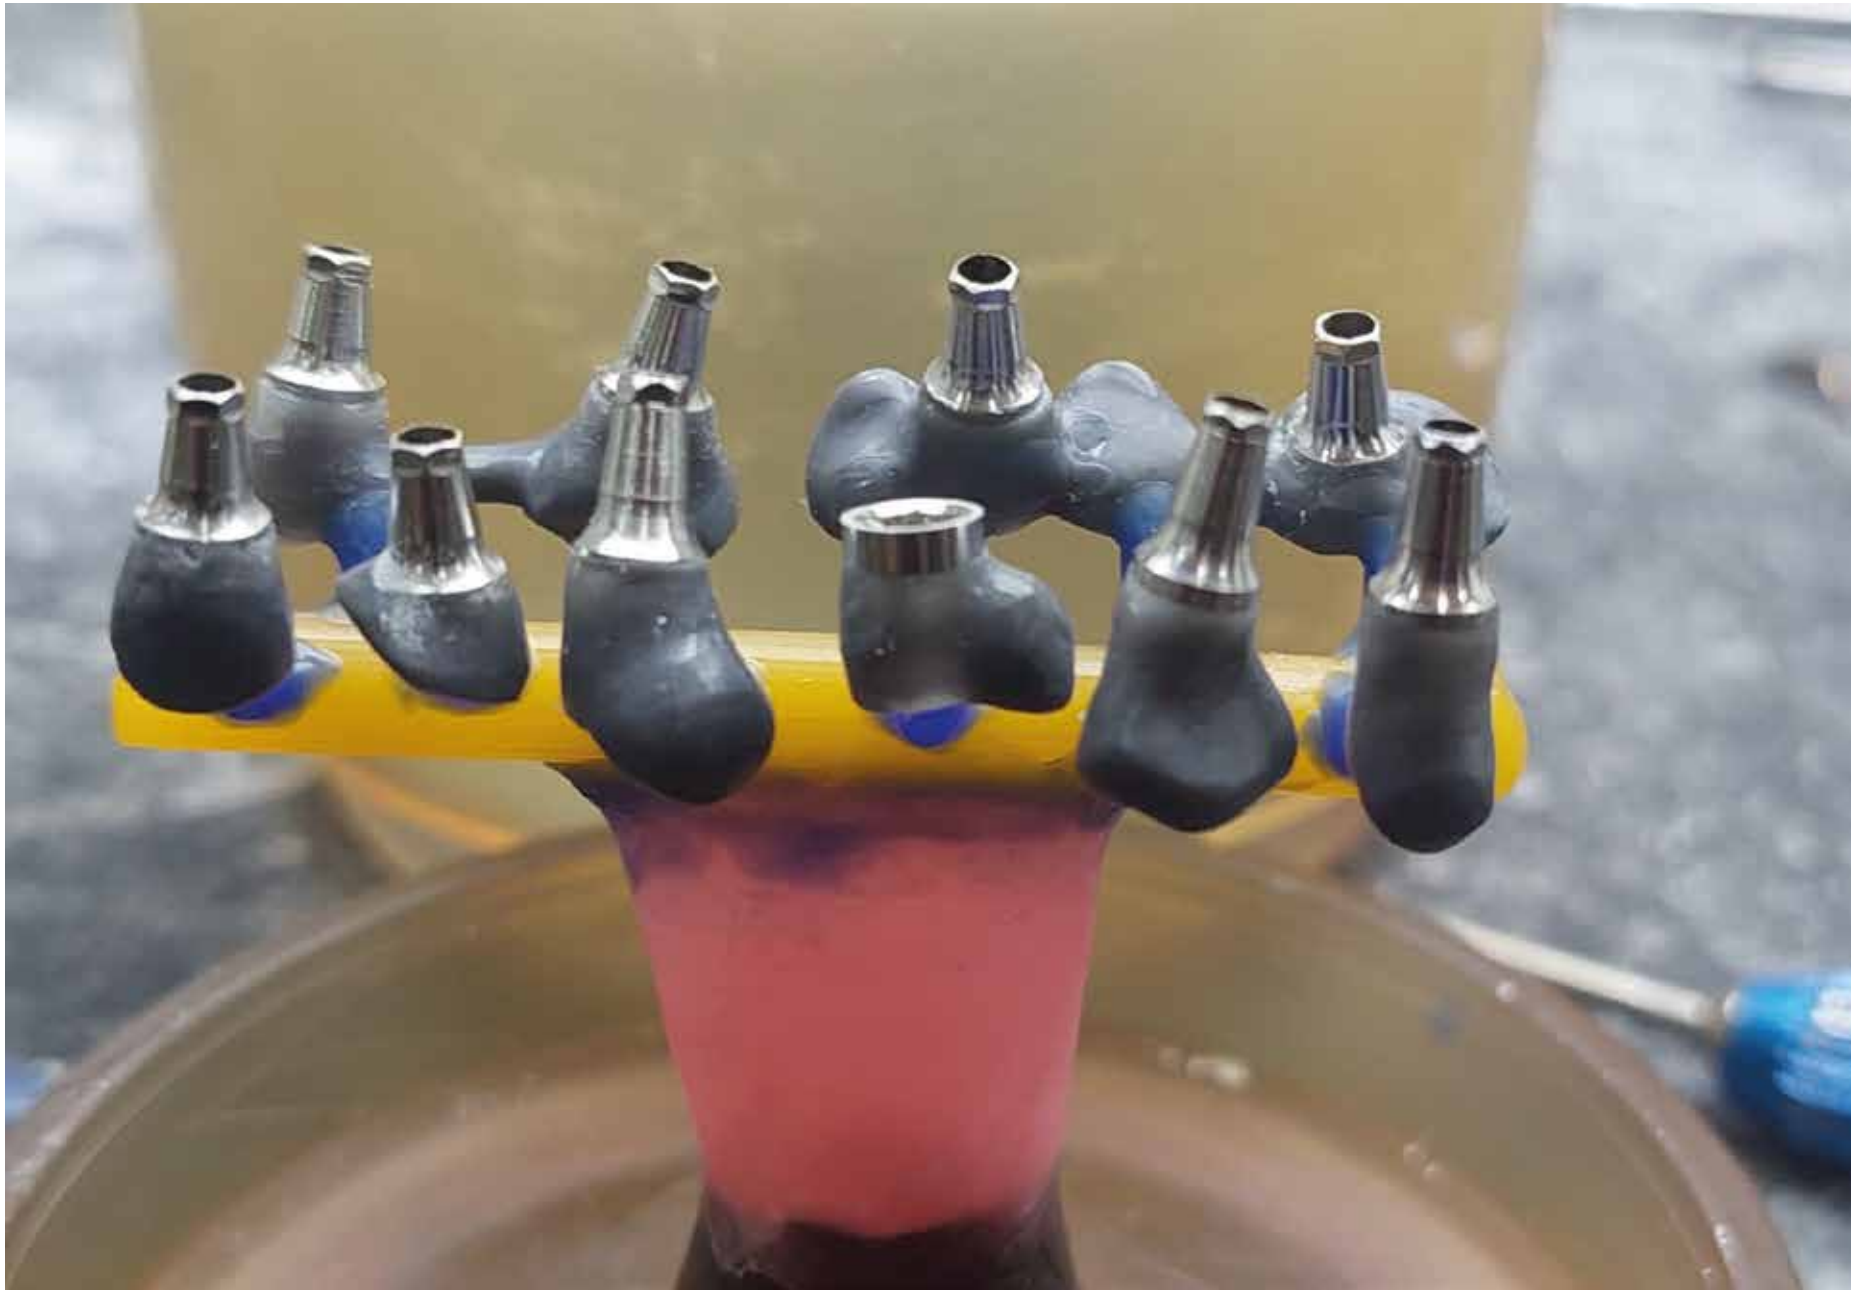

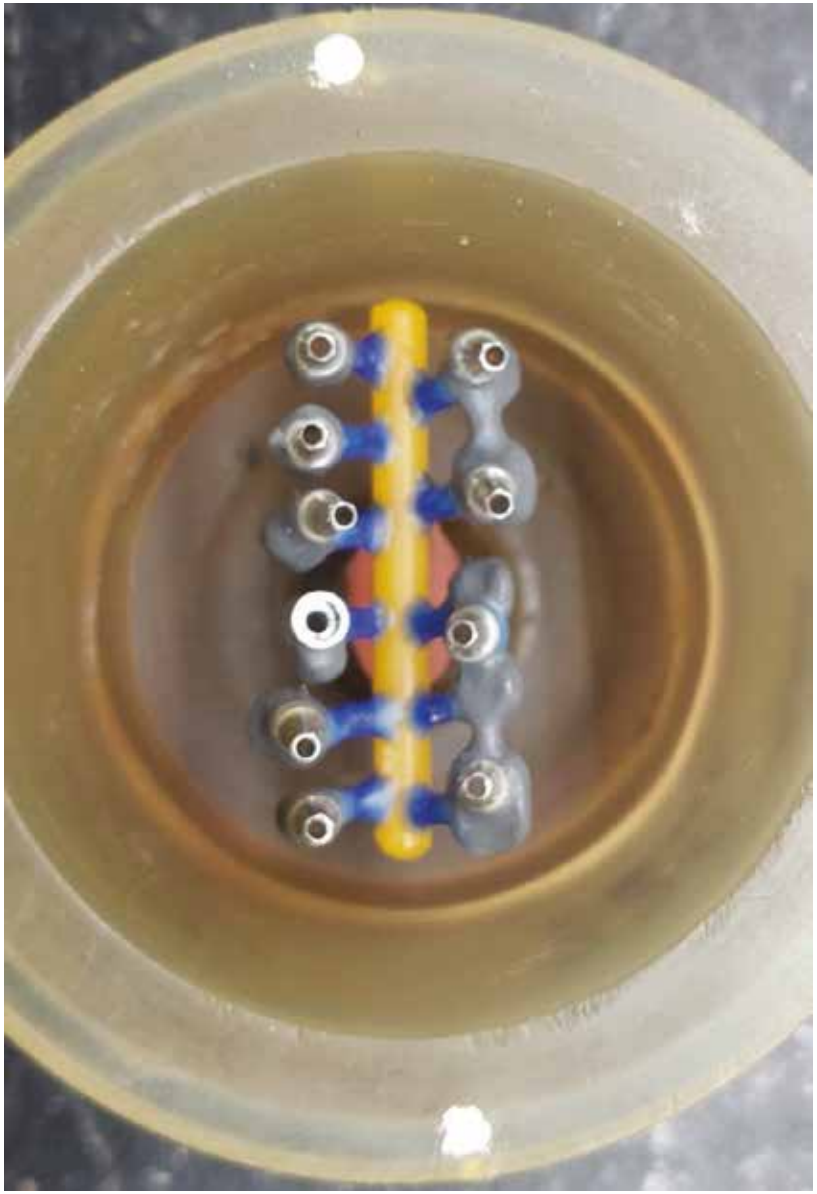

Mega Liq
Press
Mega Liq
Press
MegaVest
Press
MegaVest
Press
MegaVest
Press
MegaVest
Press
REVESTIMENTO UNIVERSAL
PARA CERÂMICA
PRENSADA E FUNDIÇÃO
TÉCNICA DE AQUECIMENTO
RÁPIDO OU CONVENCIONAL

VULCAN™ 3-130
°C / °F
920°C 6 14H 4
ESC
S
S

ODONTOMEGA
1L

vacuômetro
mm Hg
PROTÉCNI
temporizador
vácuo
01.00
pgm
PROTÉCNI
ESPATULADOR
À VÁCUO

SAMSUNG
94% 18:00
Alarme
Relógio mundi
Cronômetro
Temporizador
Horas
Minutos
Segundos
00 : 20 : 00
REINICIAR
INICIAR

vacuômetro
PROTECH
temporizador
0054
PROTECH
ESPATULADOR
À VÁCUO

°C / °F
Temp
Time
Prog
793°C 5 56H 4
ESC
S
S

Temp
Time
Prog
728°C 5 56H 4
ESC
S
S

87% 19:13
Alarme
Relógio mundi..
Cronómetro
Temporizador
Horas
Minutos
Segundos
01 : 00 : 00
REINICIAR
Temp
Time
Prog
920°C 5:43H 4
°F
ESC

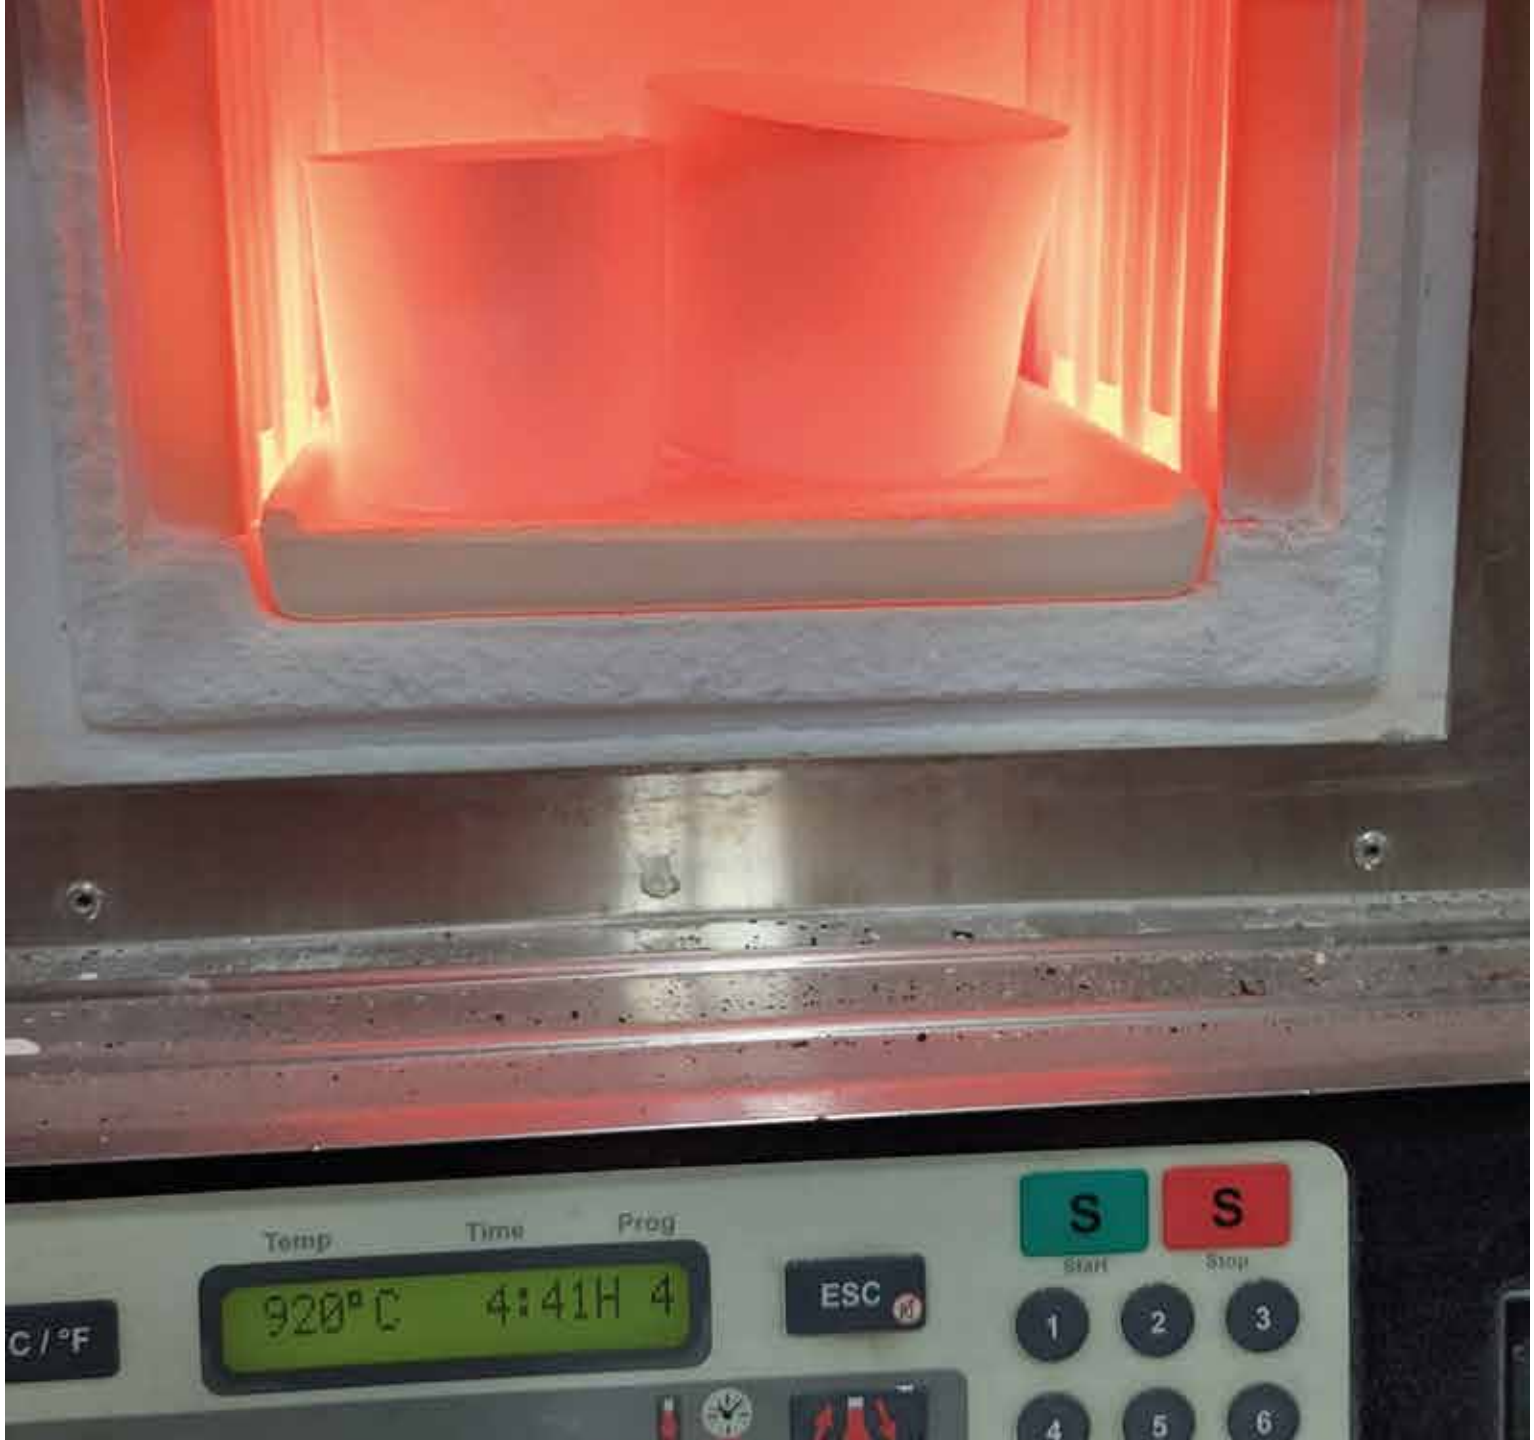
Temp
Time
Prog
920°C 4:41H 4
ESC
S
S
Start
Stop
1
2
3
4
5
6
C / °F

Eisenbacher Dentalwaren ED GmbH

Aufbrennlegierung nach DIN EN ISO 22674

ED GmbH ist zertifiziert nach DIN EN ISO 13485 / DIN EN ISO 9001

CE
0434

Kera® N

Eisenbacher Dentalwaren

LOT P 15-98

Eisenbacher Dentalwaren ED GmbH
Dr.-Konrad-Wiegand-Str. 9 • 63939 Woerth am Main
+49 / 93 72 / 94 04 - 0 • Fax 94 04 - 29 • GERMANY
www.eisenbacher.de • info@eisenbacher.de

1000 g

Oxilêa
IND. BRAS.

psi
bar
x100 kPa
0
20
40
60
80
100

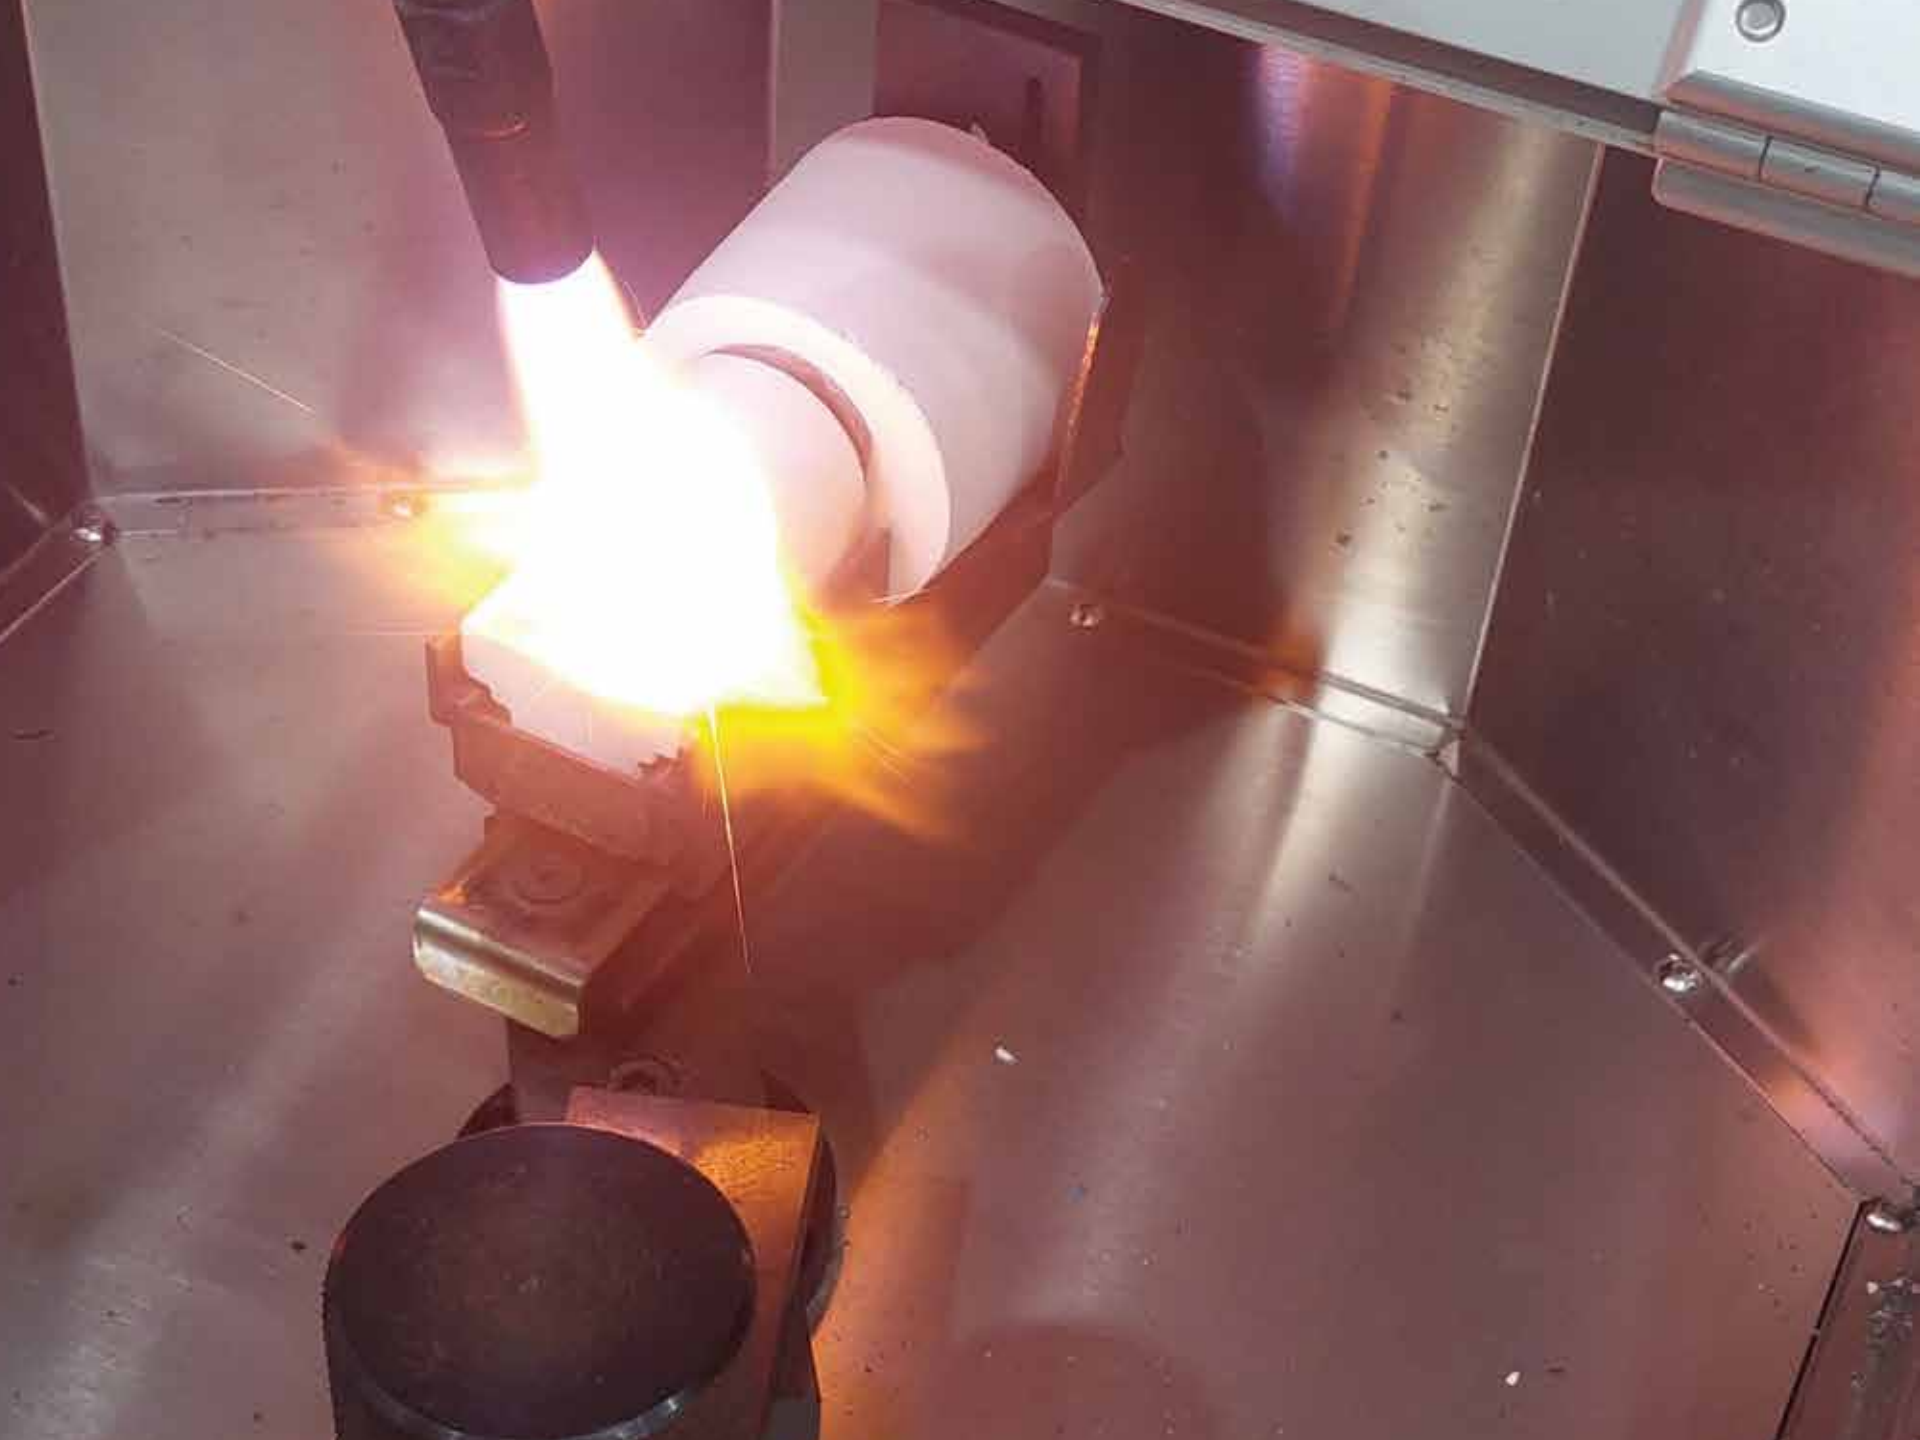

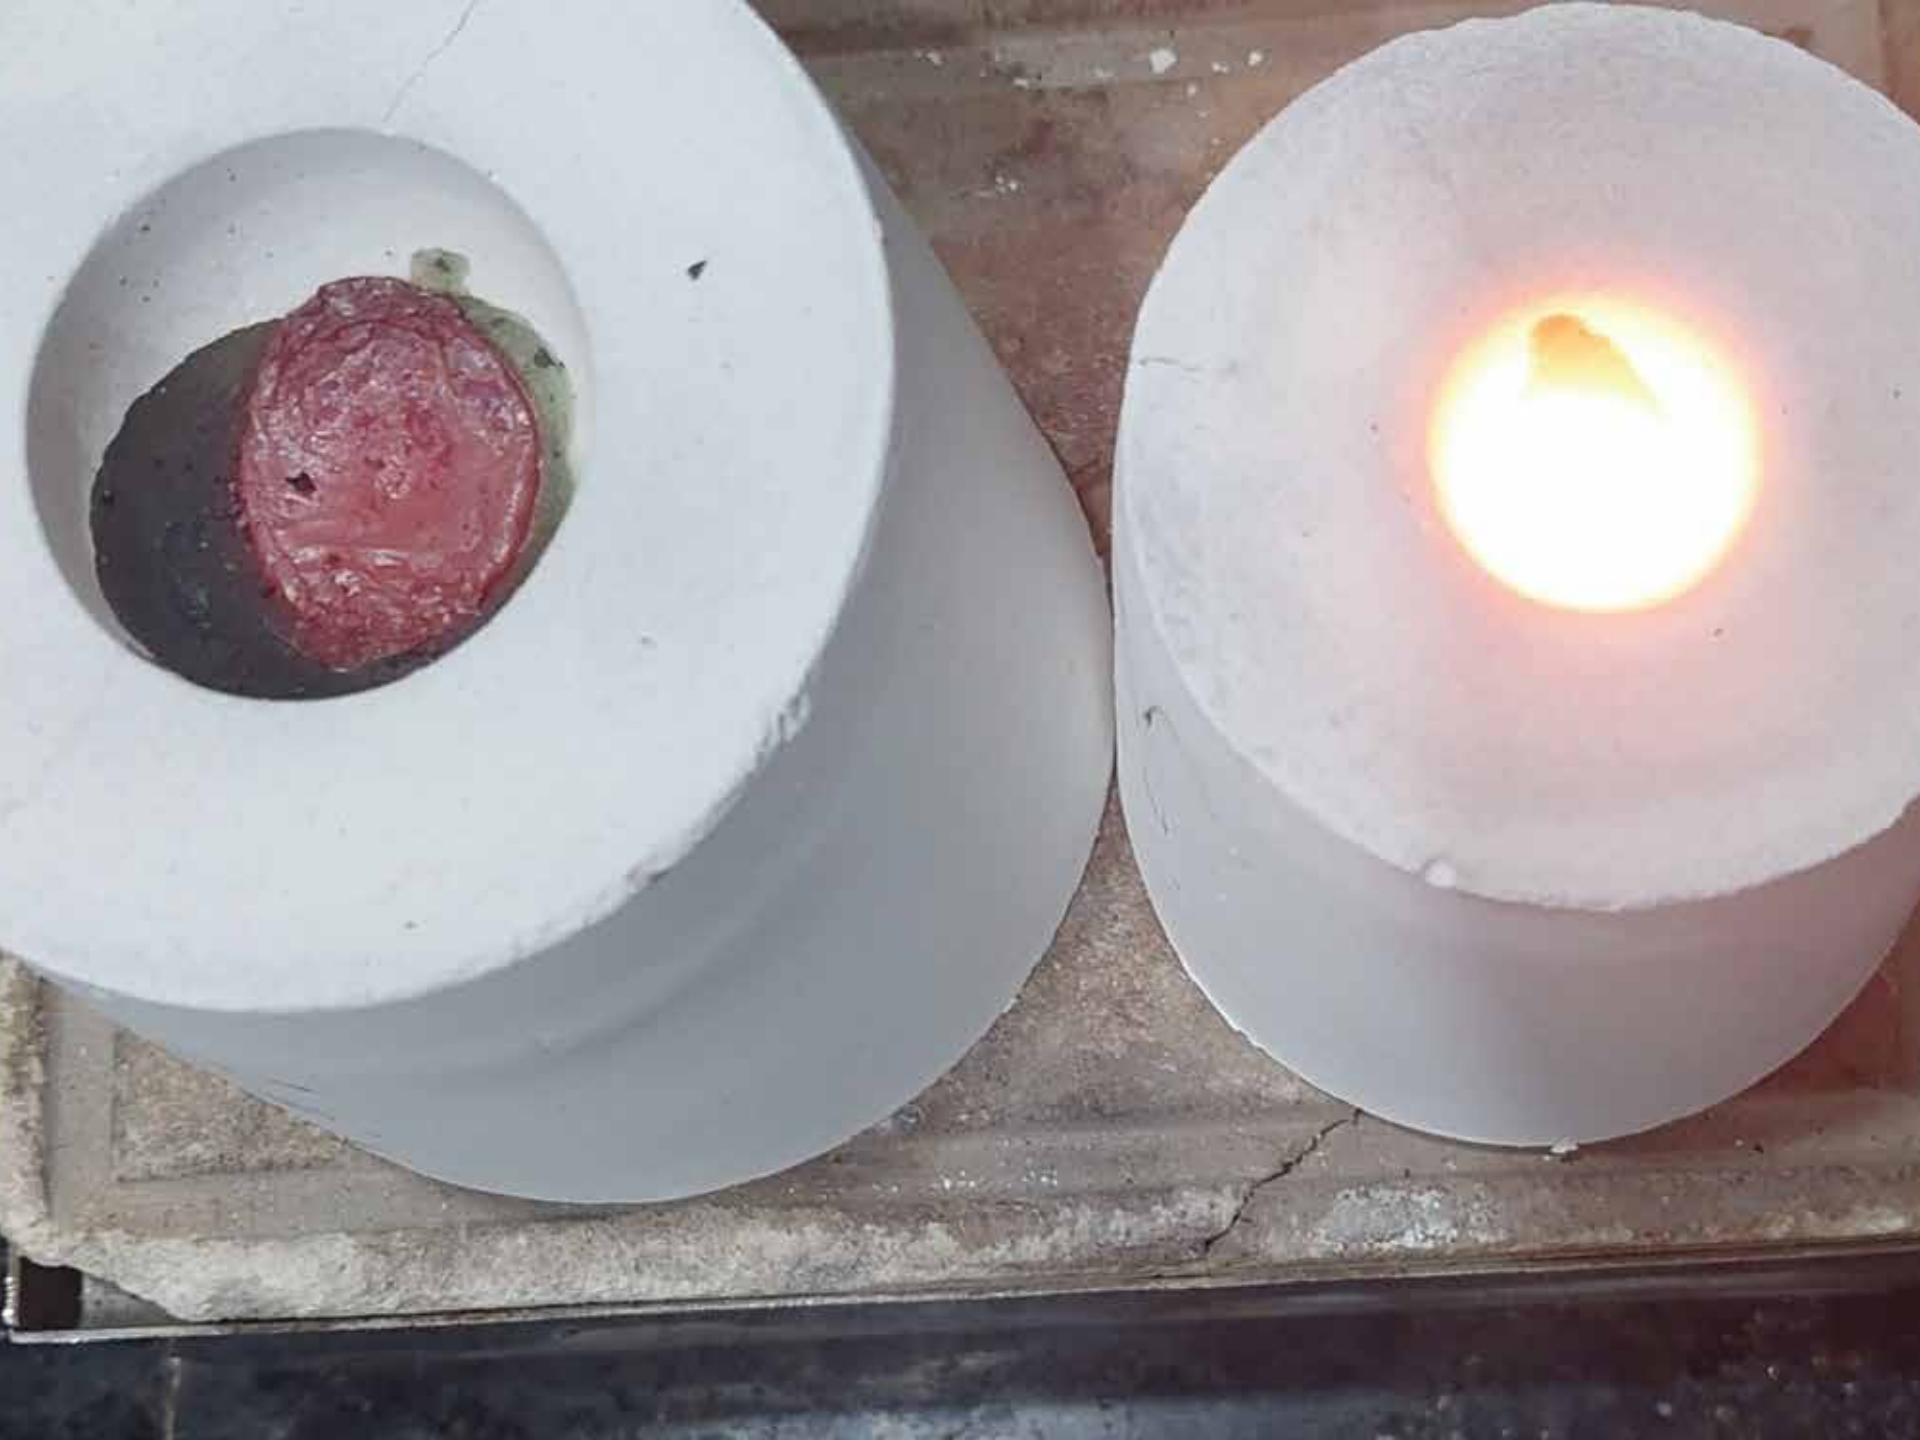

Lithium Disilicate Press Ingots
Rosetta
LT A1
LT A1
LT A1
HASS
HASS Corp.

4
2
°C / °F
Temp
Time
Prog
713°C 5:58H 4
ESC
S
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

2
4
°C / °F
Temp
Time
Prog
693°C 4 46H 4
ESC
S
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Horas
Minutos
Segundos
00 : 20 : 00
REINICIAR
Temp
Time
°F
920°C

SPEED
PRESS

bar
psi
Fluir

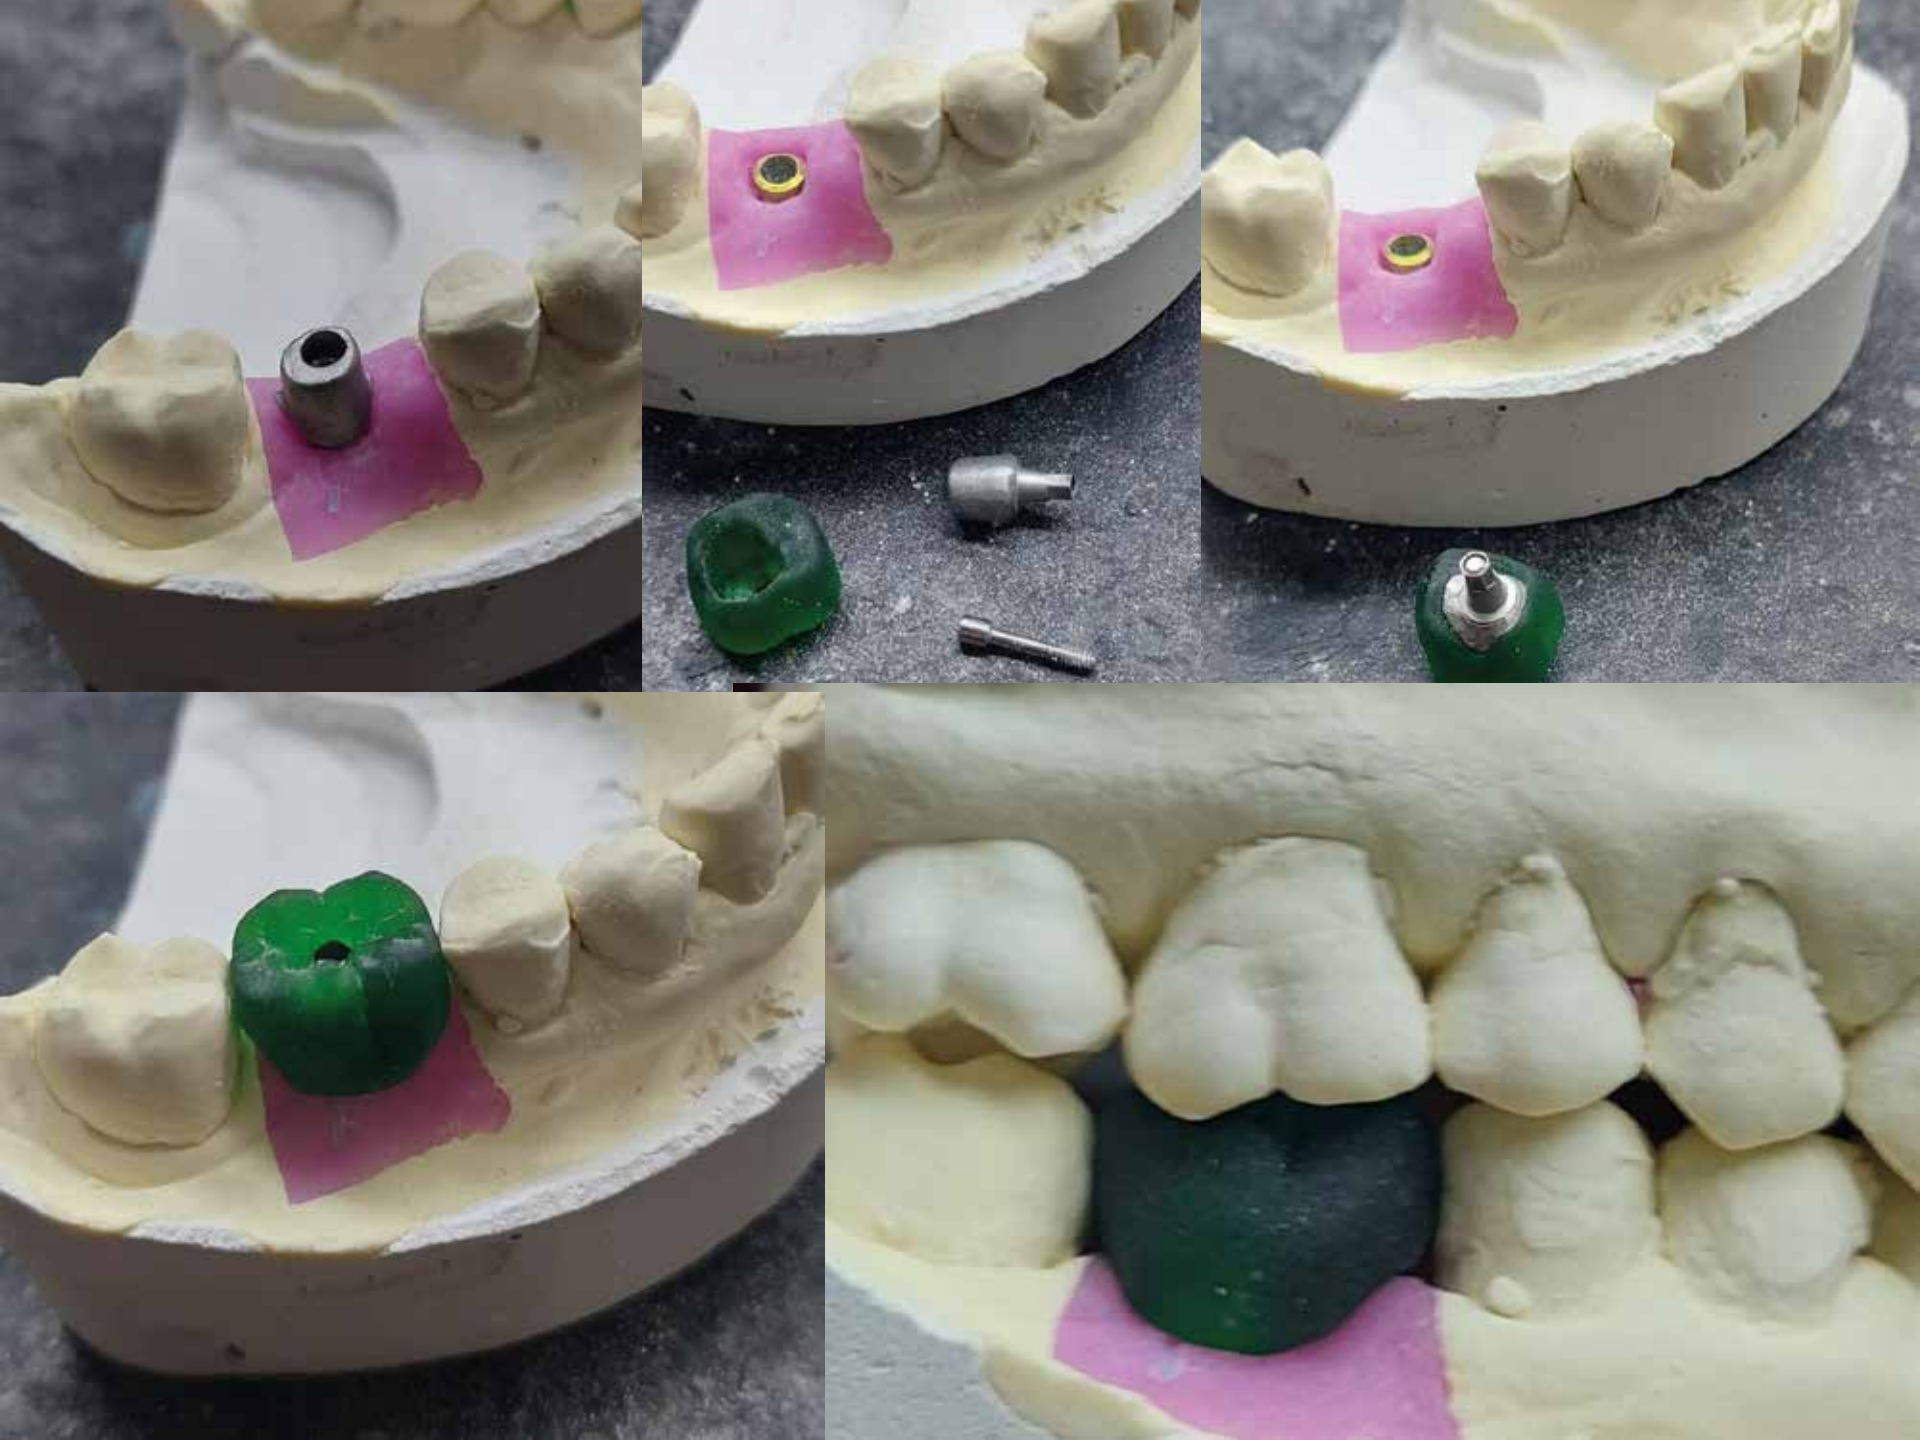

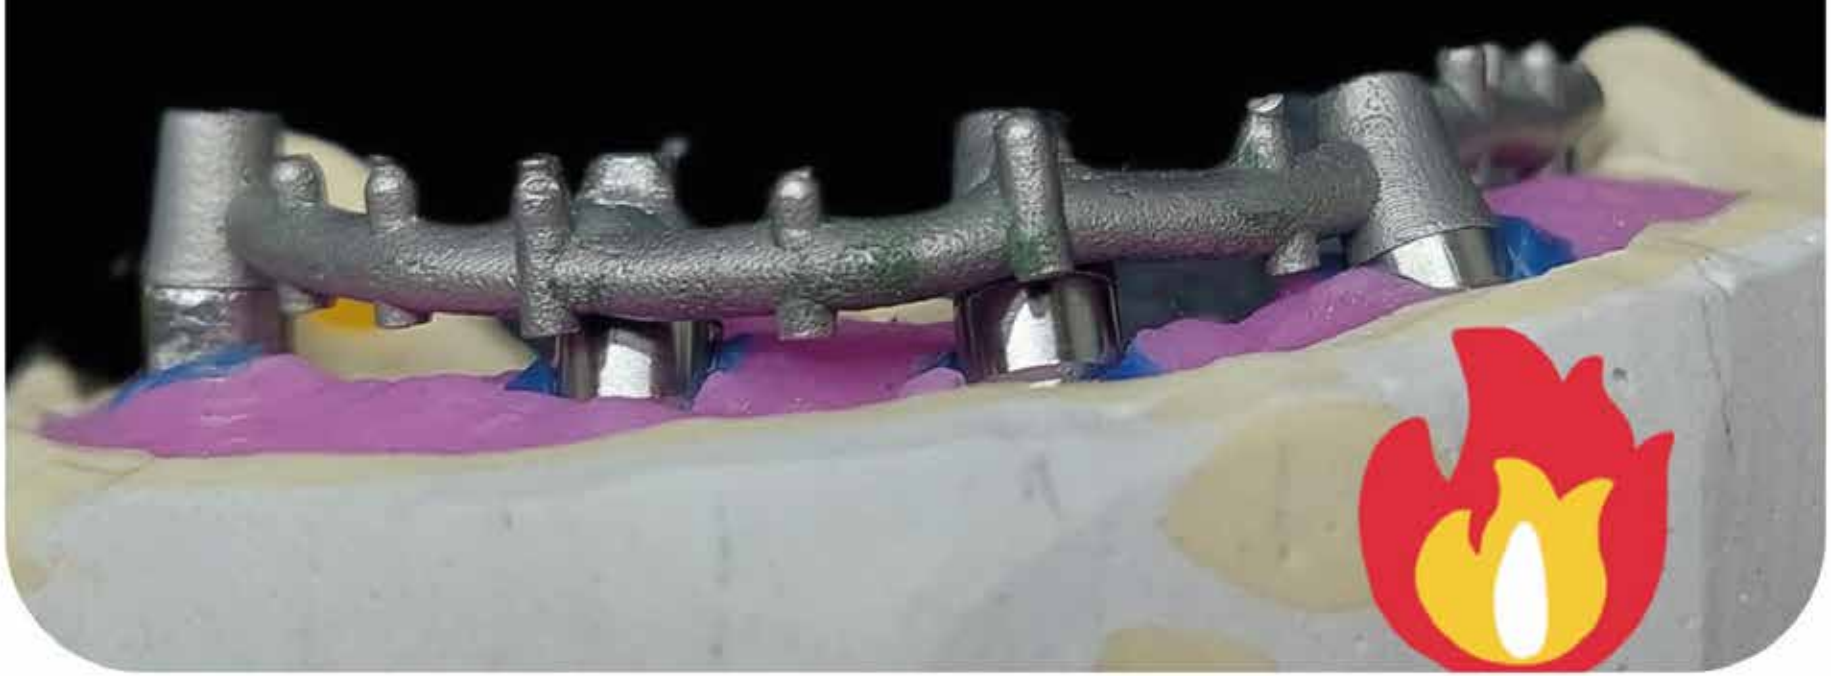

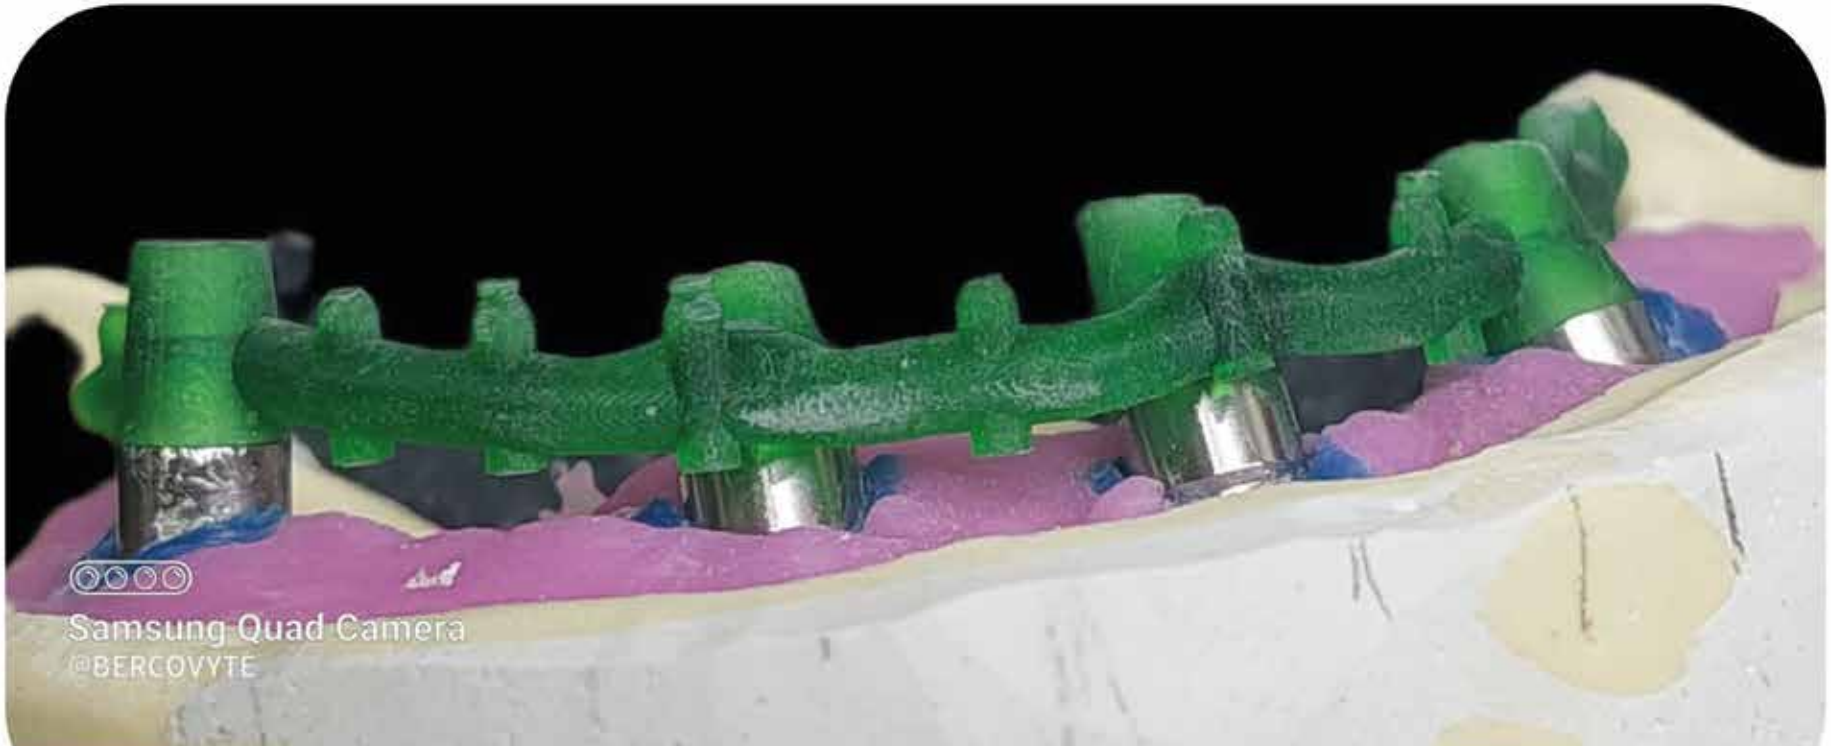
Samsung Quad Camera
@BERCOVYTE

miyo
Esthetic

ODONTOMEGA

NÚCLEO
BERCOVYTE®
LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA

@BERCOVYTE

Obrigado!

Tire suas dúvidas, me pergunte!

@bercovyte

ODONTOMEGA