InSync ceramic system em Titânio.

Ceramic System

Aplicação de Opaco

O Opaco para Titânio cobre a estrutura e cria uma excelente adesão com a cerâmica. Um bonder não é necessário. Ao trabalhar o sistema cerâmico InSync em coping e estrutura de titânio, realizar a seguinte operação antes da aplicação de massas cerâmicas.

1. Jatear a superfície inteira da peça com Mega-OX 110um. Neste processo, faíscas serão emitidas devido ao contato do titânio com o óxido de alumínio. Realizar o processo até que a peça não emita mais nenhuma faísca.

2. Limpe com jato de vapor. **Aplique a primeira queima de opaco em até 15 minutos depois de jatear com óxido.** Se demorar mais que 15 minutos, repetir o processo 1. O titânio oxida em contato com o ar, o que inviabiliza a aplicação de opaco.

3. Após a aplicação de opaco, a peça não irá oxidar, então a cerâmica pode ser aplicada normalmente, mesmo depois de muito tempo na bancada. Aplicar uma segunda queima de opaco se necessário.

4. Não utilize vácuo na queima do opaco. Utilizar misturando com líquido de opaco.

Ceramic System

Opaco disponível nas cores:

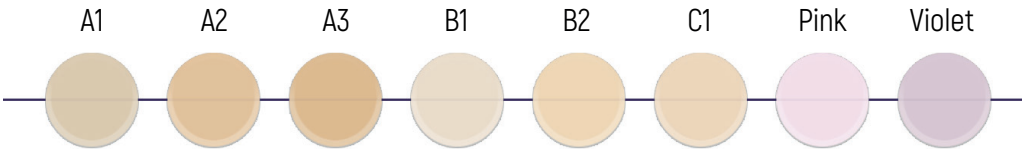

22-0000 22-0001 22-0002 22-0005 22-0006 22-0009 22-0019 22-0020

Tabela de queima

	T1 (C°)	Secagem (min)	Elevação (min)	T2 (C°)	Vácuo (C°)	Taxa de calor (C°/min)	T3 (C°)	Fim Vácuo (C°)	Manutenção (min)	Descida (min)
Queima de opaco	400	4	2	450	450	55	800	800	2	1
1ª Queima de margem	400	4	2	450	450	45	800	800	1	1
2ª Queima de margem	400	4	2	450	450	45	790	790	1	1
1ª Queima de Dentina	400	4	2	450	450	45	740	740	1	1
2ª Queima de Dentina	400	4	2	450	450	45	730	730	1	1
1ª Queima de margem	400	4	2	450	450	45	700	700	1	1
Correção	400	6	2	600	600	45	730	730	1	1
Queima de stains	400	4	-	450	-	45	735	-	1	1
Glaze sem pasta	400	6	2	600	600	45	730	730	1	1

Quaisquer dúvidas, entre em contato com a equipe OdontoMega.

(16) 3610.9636
(16) 9 9404.2888
odontomega.com.br
odontomega@odontomega.com.br

ODONTOMEGA

InSync ceramic system em Titânio.

Ceramic System

Cores disponíveis

DENTIN

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
22-0450	22-0451	22-0452	22-0453	22-0454	22-0455	22-0456	22-0457	22-0458	22-0459	22-0460	22-0461	22-0462	22-0463	22-0464	22-0465

OPACIOUS DENTIN

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
22-0300	22-0301	22-0302	22-0303	22-0304	22-0305	22-0306	22-0307	22-0308	22-0309	22-0310	22-0311	22-0312	22-0313	22-0314	22-0315

DENTIN BLEACH - CLAREADOS

BL1 (W1)	BL2 (W2)	BL3 (W3)	BL4 (W4)
22-0471	22-0472	22-0473	22-0474

ENAMEL - INCISAL

57	58	59	ENAMEL BL
22-0654	22-0655	22-0656	22-0659

TRANSPARENTE

CLEAR	NEUTRAL	OPAL
22-0705	22-0704	22-0702

CORRECTION

DENTIN	ENAMEL
22-0466	22-0657

EFFECT ENAMEL - INCISAL

MOLAR WHITE	LIGHT GREY	YELLOW	ORANGE	DARK ORANGE
22-0658	22-0653	22-0650	22-0651	22-0652

MAMELOS

SALMON	ORANGE	YELLOW	IVORY
22-0350	22-0351	22-0352	22-0353

NECK TRANSPA - CERVICAL

YELLOW	ORANGE	SALMON	KHAKI
22-0750	22-0751	22-0752	22-0753

TRANSLUCENT

YELLOW	ORANGE	LIGHT BROWN	LIGHT BLUE	INTENS BLUE	GREY	WHITE
22-0730	22-0731	22-0732	22-0733	22-0734	22-0735	22-0736

GINGIVAL

1	2	3	4	5	6	7
22-0250	22-0251	22-0252	22-0253	22-0254	22-0255	22-0256

SHADES

A	B	C	D	GLAZE
23-0833	23-0834	23-0835	23-0836	23-0819

ZR LINER

1	2	3	4	5	N
22-0770	22-0771	22-0772	22-0773	22-0774	22-0775

STAINS

ORANGE	BROWN	WHITE	MAUVE	BLUE	BLACK	LIGHT BROWN	PINK	TERRA-COTTA	YELLOW	PURPLE GREY	LIGHT BLUE	MANDA-RINE
23-0822	23-0823	23-0824	23-0825	23-0826	23-0827	23-0828	23-0829	23-0830	23-0831	23-0832	23-0837	23-0838

Preparação da estrutura - titânio

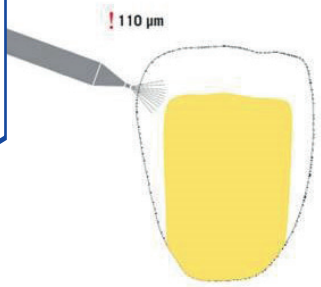

ODONTOMEGA

Ceramic System